

Lymphology □注文<sup>1</sup> □お見積り<sup>2</sup> ☼は無料オプションです。ご希望の場合は✓をお入れください。

ご連絡先(施設名、担当者名、電話番号) <sup>3</sup>		患者情報 <sup>6</sup> 注文番号 <sup>8**</sup> :		□写真メール添付 <sup>7*</sup>	
		以前の注文番号やお見積り番号/日付 <sup>9</sup>		計測手順 周径(c) 長さ(ℓ)	
お客様番号 <sup>4</sup> :		日付 <sup>5</sup> :		個数 <sup>10</sup> : □枚 <sup>11</sup> □双(ペア) <sup>12</sup>	
				□女性 <sup>13</sup> □男性 <sup>14</sup> □多様性 <sup>15</sup>	

Juzo 製品 <sup>16</sup>	mmHg	18-21	23-32	34-46	≥49
		CCL 1	CCL 2	CCL 3	CCL 4
エキスパート <sup>17</sup>		□3021	□3022	□3023	□3024
エキスパートシルバー <sup>18</sup>		□3021	□3022	□3023	□3024
エキスパートコットン <sup>19</sup>		□3021	□3022	□3023	
エキスパートストロング <sup>20</sup>		□3051	□3052	□3053	□3054
エキスパートストロング シルバー <sup>21</sup>		□3051	□3052	□3053	□3054
エキスパートストロング コットン <sup>22</sup>			□3052	□3053	

**カラー<sup>23</sup>** チェックがない場合はアーモンドになります。シルバー、コットン仕様およびCCL4はアーモンドのみ<sup>24</sup>

☼ シュガー<sup>25</sup> ☼ セサミ<sup>26</sup> ☼ アーモンド<sup>27</sup>  
 ☼ シナモン<sup>28</sup> ☼ カカオ<sup>29</sup> ☼ ポピーシード<sup>30</sup>  
 ☼ ブルーベリー<sup>31</sup> ☼ ブラックペッパー<sup>32</sup>  
 ☼ トレンドカラー<sup>33</sup> .....  
 ☼ ファッションカラー<sup>34</sup> .....

**コレクション** (Juzo エキスパート)<sup>35</sup>

**パティック**<sup>\*\*\*</sup> (CCL 1-3)<sup>36</sup> **ディップダイ** (CCL 1-2)<sup>39</sup>


□パティック-白<sup>37</sup> □ブルーベリー<sup>40</sup>  
 □パティック-黒<sup>38</sup> □ポピーシード<sup>41</sup>

**形状<sup>42</sup>**

ストッキング<sup>43</sup> □AD □AF □AG  
 パンティストッキング<sup>44</sup> □AT □片脚パンティストッキング<sup>45</sup>  
 レギンス<sup>46</sup> □BT □B-T  
 カプリ<sup>47</sup> □CT  
 ガードル<sup>48</sup> □ET 短いガードル<sup>49</sup> □FT

**下肢の仕様<sup>50</sup>**

☼ 外側オーバーハイト<sup>51</sup> □マックス<sup>52</sup>  
 ☼ 大腿前面オーバーハイト<sup>53</sup> AF / AG  
 ☼ シリコンなし<sup>54</sup>  
 ☼ シリコンすべり止め<sup>55</sup> AD (標準<sup>56</sup> 3.5 cm) □5 cm  
 ☼ シリコンすべり止め<sup>57</sup> AF / AG (5 cm) □柄入り<sup>58</sup>  
 ☼ マイクロシリコンすべり止め<sup>59</sup> AD (標準<sup>60</sup> 3.5 cm) □5 cm  
 ☼ マイクロシリコンすべり止め<sup>61</sup> AF / AG (5 cm) □柄入り<sup>62</sup>  
 ☼ レースシリコンすべり止め<sup>63</sup> (5 cm)  
 ☼ 伸縮性バンド<sup>64</sup> (幅 3.5 cm、シリコンなし)<sup>65</sup>  
 □シリコンすべり止めを生地内側に縫い込む (オーバーハイト仕様のみ可)<sup>66</sup>  
 □シリコンすべり止めを生地内側に $\frac{3}{4}$ 縫い込む (オーバーハイト仕様のみ可)<sup>67</sup>  
 シリコンスリッパ<sup>68</sup> □外側<sup>69</sup> □前面<sup>70</sup>  
 腰ベルト付き (cT点の周径を指定してください)<sup>71</sup>  
 □左<sup>72</sup> □右<sup>73</sup> □両側<sup>74</sup>  
 ☼ 大腿部切返しなし<sup>75</sup> ☼ cD点より減圧加工(ポロサ)<sup>76</sup>  
 □解剖学的に膝屈曲がみられる場合、膝窩シワの高さℓE点を記入してください<sup>77</sup>: .....

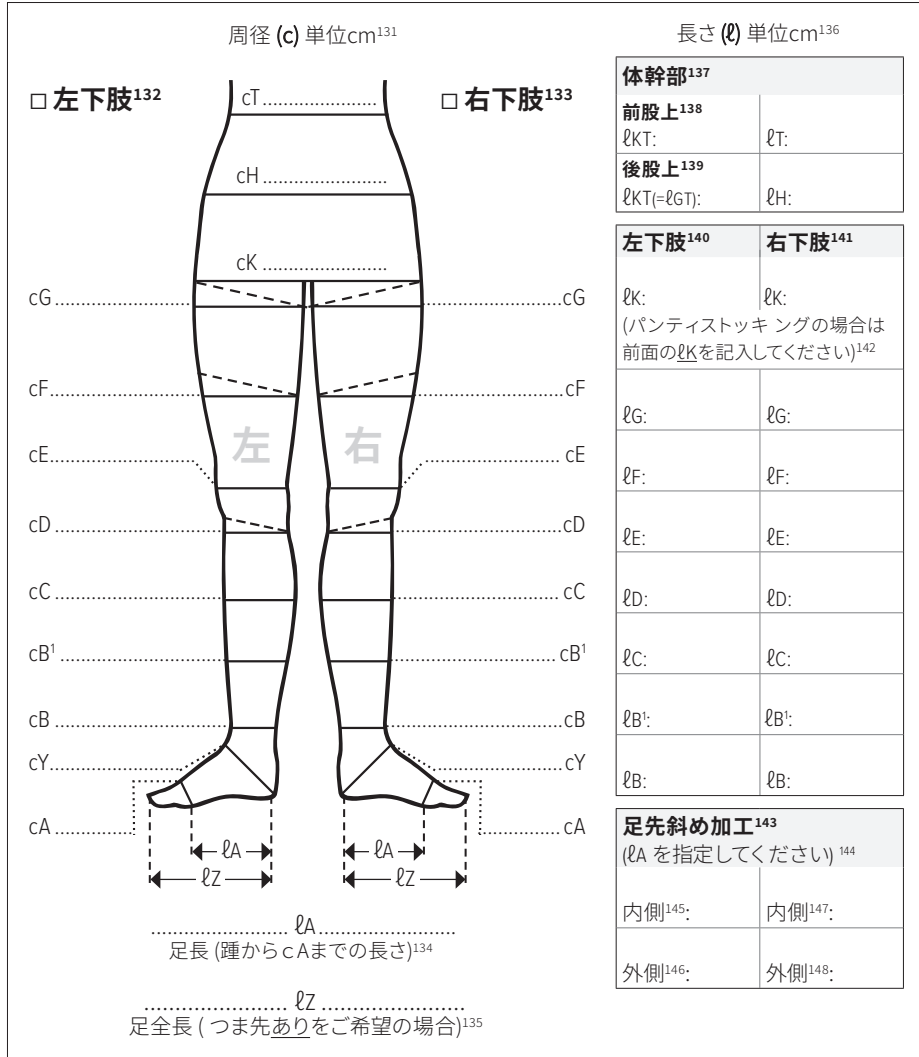

**体幹部<sup>137</sup>**

前股上<sup>138</sup> ℓKT: ℓT:  
 後股上<sup>139</sup> ℓKT(=ℓGT): ℓH:

左下肢 <sup>140</sup>	右下肢 <sup>141</sup>
ℓK:	ℓK:
(パンティストッキングの場合は前面のℓKを記入してください) <sup>142</sup>	
ℓG:	ℓG:
ℓF:	ℓF:
ℓE:	ℓE:
ℓD:	ℓD:
ℓC:	ℓC:
ℓB':	ℓB':
ℓB:	ℓB:

**足先斜め加工<sup>143</sup>**  
 (ℓAを指定してください)<sup>144</sup>

内側 <sup>145</sup> :	内側 <sup>147</sup> :
外側 <sup>146</sup> :	外側 <sup>148</sup> :

メモ<sup>149</sup>: □新しい発注書を送付してほしい<sup>150</sup>

**体幹部の仕様<sup>80</sup>** ※形状AD,AG,AFの場合にご記入は不要です。

☼ 斜め加工(標準)<sup>81</sup> ☼ ボックスタイプ<sup>82</sup> ☼ スリッパタイプ<sup>83</sup>  
 マタニティベルト (ベルクロ式)<sup>84</sup>  
 □左<sup>85</sup> □右<sup>86</sup>  
 ☼ シリコンなし<sup>87</sup>  
 □ウエストバンド<sup>88</sup> □ベルクロ式ウエストバンド<sup>89</sup>  
 □調整可能なウエストバンド<sup>90</sup>  
 □シリコンすべり止め<sup>91</sup> (5 cm)  
 ☼ 腹部<sup>92</sup> CCL 1\*\*  
 シリコンスリッパ<sup>93</sup> □外側<sup>94</sup> □前面<sup>95</sup> □後面<sup>96</sup>  
 前面中央の腹部開閉加工 (調整可能なウエストバンドタイプを除く)<sup>97</sup>  
 □ジッパー(持ち出し付き)<sup>98</sup>  
 □ジッパー(厚手タイプ持ち出し)<sup>99</sup>  
 □フックファスナー<sup>100</sup> □フックファスナー補強タイプ<sup>101</sup>  
 □ベルクロファスナー<sup>102</sup>  
 ガセット<sup>103</sup> ☼ 標準<sup>104</sup> ☼ 小さい<sup>105</sup>  
 メッシュガセット<sup>106</sup> ☼ 標準<sup>107</sup> ☼ 小さい<sup>108</sup>  
 □陰囊加工<sup>109</sup> □メンズ前開き加工<sup>110</sup>  
 □メッシュ陰囊加工<sup>111</sup>

**足部の仕様<sup>112</sup>**

つま先<sup>113</sup> ☼ なし<sup>114</sup> ☼ あり<sup>115</sup> ☼ 足先斜め加工<sup>116</sup>  
 ☼ 生地を表側に縫い目<sup>117</sup>  
 ☼ 90°(シワ抑え加工)<sup>118</sup> □cY点にトリコット裏地<sup>119</sup>  
 □Dr. Rotter スポンジ製パッド<sup>120</sup> □シリコン製パッド<sup>121</sup>  
 □糊接着<sup>122</sup> □接着なし<sup>123</sup> □挿入用ポケット加工<sup>124</sup>  
 左<sup>125</sup> □内側<sup>126</sup> □外側<sup>127</sup> 右<sup>128</sup> □内側<sup>129</sup> □外側<sup>130</sup>

日本語 7/2021 本書の内容は予告なく変更されることがあります。誤記に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

\*データ保護法の原則に基づき保有データの最小化に伴い、解剖学的に難しい特徴がある場合のみ写真を添付することをお勧めします。  
 \*\*患者さんのお名前が記載されている場合:本書を以て注文元の施設においてご本人のデータを転送・処理するために必要な法律上の同意を得られていることといたします。  
 \*\*\*パンティストッキングの弊社標準の圧クラス (CCL) : [下肢1+腹部1]、[下肢2、3、4+腹部2]。その他の組み合わせも可能です。  
 \*\*\*\*パンティストッキング(AT)のパティック仕様は鼠径部(cG)までです。